

文件编号：WU-ISCMS-QM 20214696

版本号：V2.0

受控状态：

分发号：

分子科学公共实验平台

质量管理文件

单四极杆液质联用仪 Waters UPLC-SQD2 标准操作规程 (Masslynx 版本)

2020 年 3 月 10 日发布

年 月 日实施

分子科学公共实验平台 发布

修订页

[illegible]

目 录

1. 目的.....	1
2. 范围.....	1
3. 职责.....	1
4. 色谱实验室安全管理规范.....	2
4.1. 进入或离开实验室规定	2
4.2. 实验操作规定	2
4.3. 气瓶使用规定	3
5. 色谱实验室仪器设备管理规范.....	4
5.1.1 单四极杆液质联用仪预约与使用.....	4
5.1.2 预约制度.....	4
5.1.3 培训考核制度.....	5
6. 实验内容.....	6
6.1. 实验前准备	6
6.2. 样品的准备	6
6.3. 仪器主机组成	7
6.4. Masslynx 软件.....	8
6.5. 仪器准备工作	12
6.5.1 密封件清洗（Seal Wash）	12
6.5.2 Prime solvents 灌注操作	14
6.5.3 自动进样器 Prime 操作	16
6.5.4 开质谱.....	17
6.6. 运行仪器	19
6.6.1 编辑样品表.....	19
6.6.2 编辑仪器方法.....	21
6.6.3 选择色谱、质谱方法.....	24
6.6.4 样品位置选择(Bottle)	25
6.6.5 进样体积(Inject Volume).....	26

6.6.6 保存样品表并运行方法.....	26
6.7. 数据查看	29
6.8. 实验结束处理	32
6.9. 退出操作	34
7. 相关/支撑性文件	34
8. 记录.....	34

分子科学公共实验平台

1. 目的

建立单四极杆液质联用仪(UPLC-PDA-SQD2) (Masslynx 软件版本) 使用操作规程, 使其被正确、规范地使用。

2. 范围

本规程适用于所有使用单四极杆液质联用仪 (Masslynx 软件版本) 的用户。

3. 职责

3.1. 用户: 严格按本程序操作, 发现异常情况应及时汇报实验室技术员。

3.2. 实验室技术员: 确保操作人员经过相关培训, 并按本规程进行操作。

3.3. 文章致谢格式:

根据学校指导意见, 使用各校级平台仪器设备表征产生的科研成果必须致谢平台。如果您在文章成果中使用了光谱、色质谱、磁共振波谱以及其他属于分子科学平台的仪器设备, 请务必在文末致谢分子科学公共实验平台。

英文文章致谢:

① Acknowledgement: The author thanks (Dr. XXX from) Instrumentation and Service Center for Molecular Sciences at Westlake University for (the assistance/discussion/supporting in) ... measurement/data interpretation.

② Coauthorship on the resulting publications would be appreciated if our staff make technical contributions (including but not limited to critical sample preparation, novel experiment designation and comprehensive data analyzation).

Affiliation address: "Key Laboratory of Precise Synthesis of Functional Molecules of Zhejiang Province, School of Science, Instrumentation and Service Center for Molecular Sciences, Westlake University, 18 Shilongshan Road, Hangzhou 310024, Zhejiang Province, China."

中文文章致谢:

① 致谢: 感谢西湖大学分子科学公共实验室平台 XXX 博士(或者 XXX 老师)在.....表征或数据分析上提供的帮助。

② 共同作者: 如果分子科学平台老师在您课题组样品表征或文章发表上有重要技术贡献(包括但不限于关键样品制备、新型实验设计和深度数据分析), 我们

感谢您将相关老师列为共同作者, 作者单位地址如下: 西湖大学, 分子科学公共实验平台, 功能分子与精准合成浙江省重点实验室, 杭州, 310030, 浙江。

4. 质谱实验室安全管理规范

4.1. 进入或离开实验室规定

- 4.1.1. 进入实验室之前必须通过学校、中心和平台的安全考试或考核, 严格遵守本实验室的各项安全警示标识。
- 4.1.2. 进入质谱实验室, 请仔细阅读本实验室的安全管理规定。
- 4.1.3. 进入实验室需穿戴实验服, 严禁穿拖鞋、高跟鞋进入实验室, 长发请束发。
- 4.1.4. 进入实验室应了解消防器具与紧急逃生通道位置, 实验室通道及消防紧急通道必须保持畅通。
- 4.1.5. 严禁将自己授权的门卡转借他人, 一旦发现将进行禁用处理。
- 4.1.6. 禁止将实验无关人员带入实验室。
- 4.1.7. 严禁在实验室饮食、吸烟或随意走动。
- 4.1.8. 夜间实验, 需两人在场。
- 4.1.9. 为保持实验室内环境温度及湿度稳定, 进入实验室后保持实验室门窗关闭。实验结束后, 实验人员必须进行清场。最后离开实验室人员需检查水、电、门窗等。
- 4.1.10. 严禁戴手套接触门把手或电梯。禁止随意丢弃实验废弃物。
- 4.1.11. 实验室应保持整洁, 严禁摆放与实验无关的个人物品。
- 4.1.12. 空压机及 UPS 所处房间应使用空调, 要保持室内空气干燥, 在潮湿的季节应该除湿。至少每周一次检查除湿机有无积水。

4.2. 实验操作规定

- 4.2.1. 实验室内均为大型科研设备, 有专人负责管理, 未经培训人员, 不得擅自上机使用。
- 4.2.2. 送样或自主上机的用户, 均需使用大仪系统进行系统。
- 4.2.3. 请严格按送样要求进行制样。由于样品问题造成色谱柱损坏或仪器配件更换, 无论独立上机或是委托测试, 费用将由用户所在课题组承担;

- 4.2.4. 请严格按仪器操作规程进行操作。实验过程中有任何不确定必须联系技术员, 自主上机因操作错误造成设备或色谱柱等损坏的, 该用户课题组也需承担相关费用。
- 4.2.5. 实验过程中如发现仪器设备发生异常状况、仪器报错、报警等, 务必立即联系仪器负责人严禁擅自处理、调整仪器主要部件, 凡自行拆卸者一经发现将给予严重处罚。
- 4.2.6. 色谱类仪器, 必须根据样品分离方法和要求, 选择合适的色谱柱或设置洗脱梯度、进样盘等, 因用户本人选择色谱柱或梯度设置错误, 导致仪器故障或色谱柱耗材损坏的, 所有费用由课题组全权负责。
- 4.2.7. 仪器均为高压设备, 使用仪器需严格遵守用电安全规定, 严禁擅自更改电路或切断仪器电源等相关危险操作。
- 4.2.8. 实验室内的药品、试剂必须存放药品柜, 并做好使用登记。
- 4.2.9. 使用化学试剂或药品前, 必须了解其物理化学性质、毒性及防护方法, 使用时必须配戴护目镜、手套等, 做好个人防护。
- 4.2.10. 非常规实验测试须技术员同意并指导方可进行。实验数据须通过学校数据中心进行下载, 禁止将个人 U 盘、移动硬盘等易带入病毒的存储设备与各色质谱仪器工作站连接拷贝数据。
- 4.2.11. 垃圾、废液必须严格按标识进行分类, 禁止将锐器、玻璃丢弃在常规垃圾箱中。
- 4.2.12. 自主上机用户须在预约时间内须使用本人的账号登陆基理系统进行仪器使用; 使用结束应做好仪器使用等级, 如实记录仪器使用状态。

4.3. 气瓶使用规定

- 4.3.1. 首次使用实验室气瓶, 须经实验室技术员培训指导。
- 4.3.2. 请按实验室气瓶标识选择正确的气源。
- 4.3.3. 打开气瓶, 先确认管路已连接稳妥, 禁止未接气路或气路未连接稳妥, 开气瓶减压阀。
- 4.3.4. 更换气瓶, 首先确保减压阀关闭, 且管路中气压排空归零, 先用扳手拧松后, 再用手旋下管路。换气瓶, 确认气瓶螺纹吻合后, 先手紧气体管路, 再用扳手拧 1/8 圈左右。

- 4.3.5. 开气瓶或更换气瓶, 禁止站在减压阀出气口正前方。
- 4.3.6. 测试过程中, 请根据需要及时更换气瓶。使用者应根据气瓶使用情况, 变更气瓶使用牌状态“满瓶”/“使用中”/“空瓶”等。
- 4.3.7. 气瓶应保持正立并固定。

5. 质谱实验室仪器设备管理规范

5.1.1 单四极杆液质联用仪预约与使用

该仪器遵从学校“科研设施与公共仪器中心”对大型仪器设备实行的管理办法和“集中投入、统一管理、开放公用、资源共享”的建设原则, 面向校内所有教学、科研单位开放使用; 根据使用机时适当收取费用; 并在保障校内使用的同时, 面向社会开放。

该仪器的使用实行预约制度, 请使用者根据样品的测试要求在学校“大型仪器共享管理系统”(以下简称大仪网)进行预约, 并按照要求登记预约信息。

1. 委托测试

- ① 送样前与仪器负责人沟通样品信息。
- ② 请在大仪网进行送样预约并将制备好的样品交给仪器负责人。
- ③ 测试结果请自行在数据中心进行下载。
- ④ 样品如需回收请在测试后尽快取回, 一周未取回平台将作化学废弃物处理。

2. 自主上机

- ① 质谱仪器培训至少需要两小时, 申请培训前先与仪器负责人联系。
- ② 请在大仪网预约培训机时, 培训时请携带纸质版仪器培训申请表。
- ③ 技术员进行现场培训。
- ④ 培训后两周内, 用户可在技术员指导下用实际样品进行上机测试, 并按自主上机计费; 根据自身掌握情况, 用户需在两周内进行上机考核, 考核通过的用户即获得自主上机权限, 原则上一星期复考; 未考核或考核不通过的用户, 需重新接受培训。

5.1.2 预约制度

为充分利用仪器效能、服务全校科研工作, 根据测试内容与时间的不同, 实验室仪器需进行网上预约制度。单四极杆液质联用仪使用涉及流动相更换, 自主上机用户需根据预约制度登陆大仪共享网站最少提前 30 分钟预约机时, 包括周

末；寒暑假及法定节假日请关注实验室实时通知。

请严格遵守预约时间使用仪器，以免浪费机时。如需调换时间段，在技术员同意下可与其他使用者协商。因故不能在预约时间内测试者，请提前 30 分钟取消预约并通知技术员。恶意预约机时或有多次无故不遵预约时间的用户，实验室将进行批评教育、通报批评或取消上机资格等处罚。

预约时段		预约时间	测试内容
周一至周日	09:00 至 22:00	不限制	液质分析

- (1) 校内使用者须经过技术员的实验操作培训，考核合格后方可上机使用；
- (2) 实验开始时务必在实验记录本上登记，结束后如实记录仪器状态；
- (3) 严禁擅自处理、拆卸、调整仪器主要部件。使用期间如仪器出现故障，使用者须及时通知技术员，以便尽快维修或报修，隐瞒不报者将被追究责任，加重处理；
- (4) 因人为原因造成仪器故障的(如硬件损坏)，用户课题组须承担维修费用；
- (5) 本实验室所有原始数据不允许在仪器工作站上删改，尤其不允许用 U 盘与移动硬盘直接拷贝。用户应根据要求通过科研仪器网/数据服务器传送下载原始数据至本地电脑，以保存并做数据处理；实验数据在本实验室电脑中保留 2 年。
- (6) 用户应保持实验区域的卫生清洁，测试完毕请及时带走样品，技术员不负责保管。

使用者若违犯以上条例，将酌情给予警告、通报批评、罚款及取消使用资格等惩罚措施。

5.1.3 培训考核制度

校内教师、研究生均可提出预约申请，由技术员安排时间进行培训，培训内容包括仪器使用规章制度、送样须知及安全规范、基本硬件知识、标准操作规程（自主测试）及相应数据处理。

培训结束后，两周内培训者需管理人员监督下进行 5 次左右操作，培训者根据自己的掌握程度，联系技术员进行上机考核。初级考核合格后，可在管理人员监督下上机操作，一周后复考。

实验室技术员认为培训者达到独立操作水平后, 给予培训者授权在所允许的可操作实验范围内独立使用仪器。如果因为人为操作错误导致仪器故障者, 除按要求承担维修费用之外, 给予重考惩罚、培训费翻倍。

对接受培训人员的核心要求:

- (1) 了解液相色谱、低分辨液质的基本原理及其应用的多学科背景知识;
- (2) 熟练掌握 Masslynx 软件系统, 严格按照标准操作规程操作, 防止因人为操作不当造成仪器故障, 认真做好仪器的使用及故障记录。

6. 实验内容

6.1. 实验前准备

- (1) 检查流动相、洗针液等的成分和体积, 确保可以完成测试;

常用流动相: 流动相A: H₂O (超纯水, 0.1%FA)

流动相B: ACN (Fisher, LC-MS, 0.1%FA)

注: 需要用特殊流动相, 务必提前与技术员协商, 确认色谱柱和仪器兼容, 请根据色谱洗脱梯度及实验室需要配置所需流动相;

本仪器当前只使用反相色谱模式。

该仪器默认为反相模式, 接C18色谱柱。

其他溶液: Seal Wash (高比例水相): 10%ACN+90%H₂O;

SNW (高比例有机相): 90%ACN+10%H₂O;

注意事项: 甲酸为LC-MS级别 (冰箱保存); 配制好流动相超声脱气5分钟

- (2) 按要求制备样品。

6.2. 样品的准备

- ① 溶剂: 建议用初始比例流动相溶解样品, 次之可甲醇/乙腈/水极性溶剂溶解且要求去盐;
- ② 浓度与体积:
 - a) 液质联用样品浓度不超过5 ppm, 建议送样量1.0 ml;
 - b) 珍贵样品, 可使用内衬管样品瓶。
- ③ 样品处理: 上机前最后一步过0.22 μm膜过滤后或者超离心 (11000 rpm, 15-20 min取上清液)
- ④ 容器: 预开口2 ml样品瓶, 完成后对着灯光检查确保瓶中没有气泡。

- ⑤ 禁止因素：控制好浓度；无盐，无无机酸碱，无特殊有机溶剂，无表面活性剂、离子液体等。

补充说明：样品溶液须过滤澄清，严禁含有不可溶性颗粒或含有蛋白质、核酸、多糖等大分子；样品溶液pH在2-8范围内，生物样品、微生物培养液等样品，必须经过去除蛋白质、脂类和多糖的操作，然后用流动相溶解；不得含有表面活性剂；不得含有机或无机强酸强碱、三氟乙酸等。送样需说明样品保存条件、稳定性、溶解性、毒性、余样是否需要取回等信息。

重要提醒：1) 送样人员必须对测试样品的合法性负责，未注明合法性和物理化学性质的样品不予测试。如测试过程中发现样品含毒品类非法样品，送样人将负法律责任。

2) 因送样溶液不符合要求而导致管道堵塞或对仪器造成损坏的，根据情节严重情况进行通报批评、禁用或赔偿等处罚。

注意：由于用户的样品问题导致仪器异常或配件更换，所有责任将由用户及所在课题组或单位承担。

6.3.仪器主机组成

如图 6-1，单四极杆液质联用仪硬件包括以下几个部分：PDA 检测器、柱温箱、自动进样器、溶剂管理器、四极质谱检测器以及流动相瓶等。

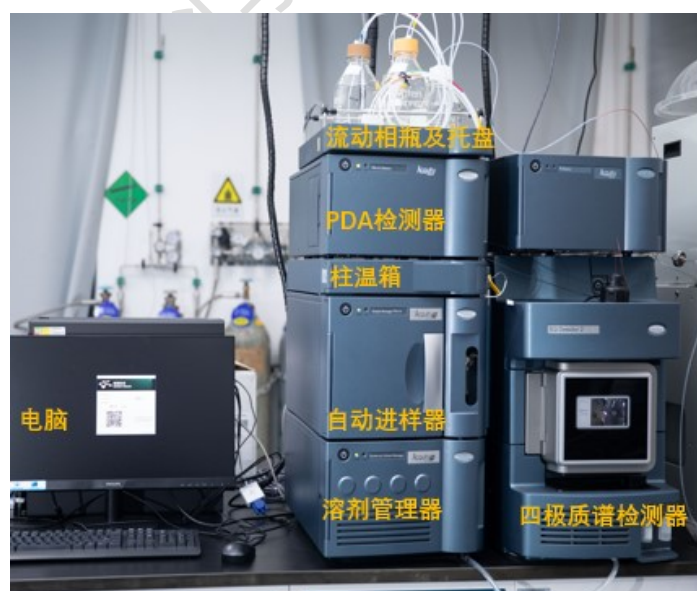


图 6-1

6.4. Masslynx 软件

6.4.1. 基理系统登陆

接入大仪网的仪器操作电脑均需要登陆基理锁屏界面。

- (1) 如图 6-2(a), 如界面显示“一卡通用户”, 请在 Account 输入预约者的一卡通账户, Password 栏输入相应账户密码, 点击 Submit;

注意: 如账号或密码输入错误, 请按键盘 Delete 键进行删除, 再重新输入; 禁止点击 Cancel, 否则仪器会自行关机。

- (2) 如图 6-2(b), 如界面显示“LIMS User”, Account 显示 Administrator, 请与相关老师联系。



图 6-2

6.4.2. 软件图标

本仪器使用的操作软件为 Masslynx (图 6-3)。使用完仪器, 关闭流速和温度, 质谱设置待机后, **不退出软件**, 只需双击电脑任务栏图标, 即可进入软件界面。




图 6-3



图 6-4

6.4.3. 打开项目文件和进样表

系统中已有项目文件的用户, 请选择 File - Open project 打开项目文件, 并进一步选择 file-open... 打开自己的 sample list, 具体如下:

注: 系统中没有课题组项目文件的用户, 请联系仪器技术员。

Step 1. 点击仪器任务栏最小化的Masslynx图标 (图6-5), 默认显示为上一次仪器实验的测试序列(图6-6)。



图 6-5

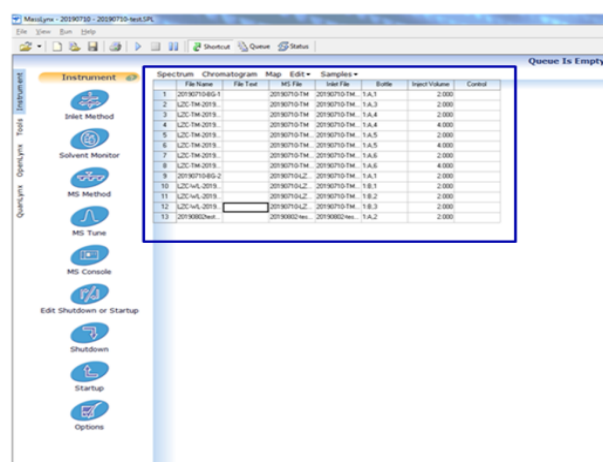


图 6-6

Step2. 点击 File – Open Project... (图 6-7), 弹出 6-8 对话框, 点击 Yes

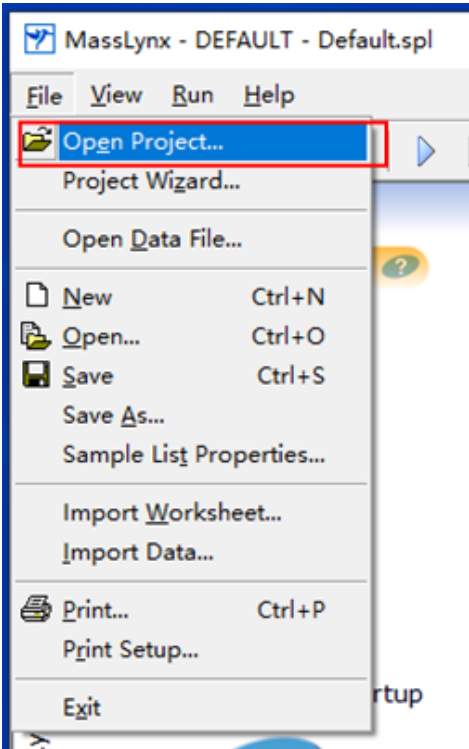


图 6-7

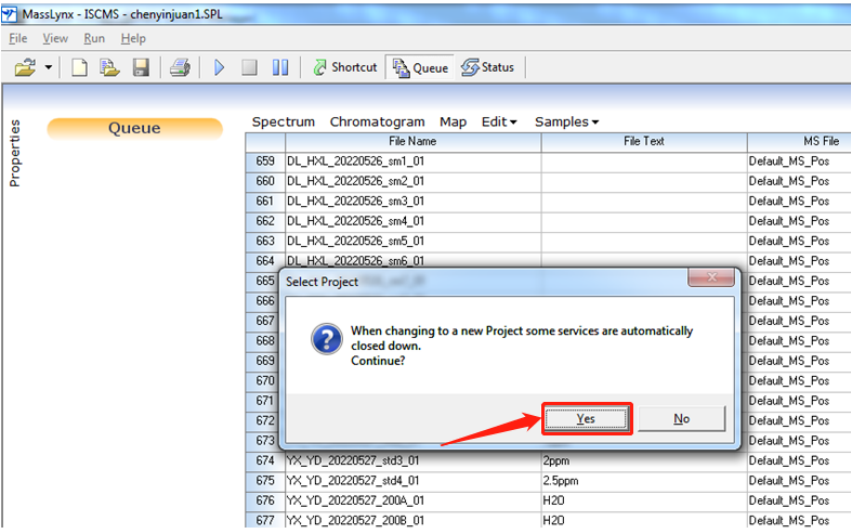


图 6-8

Step3. 选择项目文件

如图 6-9，根据电脑的数据存储路径，选择自己课题组的项目文件。**课题组**的项目文件，通常以课题组负责姓名命名。比如选择 ISCMS.PRO，即可显示该项目文。

注：不清楚存储路径，请联系技术员。

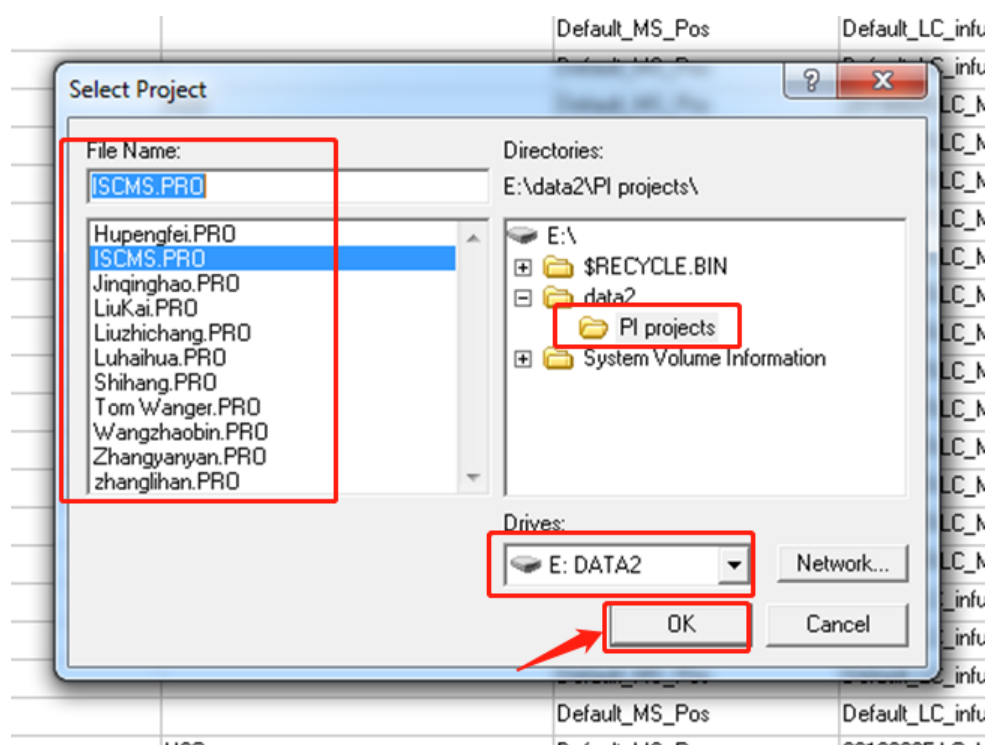


图 6-9

Step4. 选择个人进样表

在课题组的项目文件下，进一步点击 File – Open... (图 6-10)，弹出 6-10 对话框，选择个人进样列表-Open，即可显示该项目文件下的用户个人进样列表情况 (图 6-11)。窗口右上角会有 Masslynx-project-sample list 显示，如 Masslynx-ISCMS -chenyinjulan1.spl。

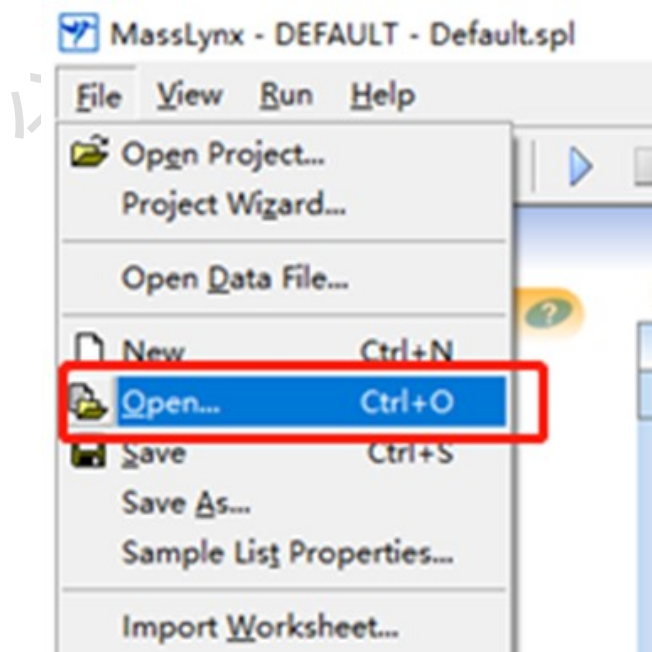


图 6-10

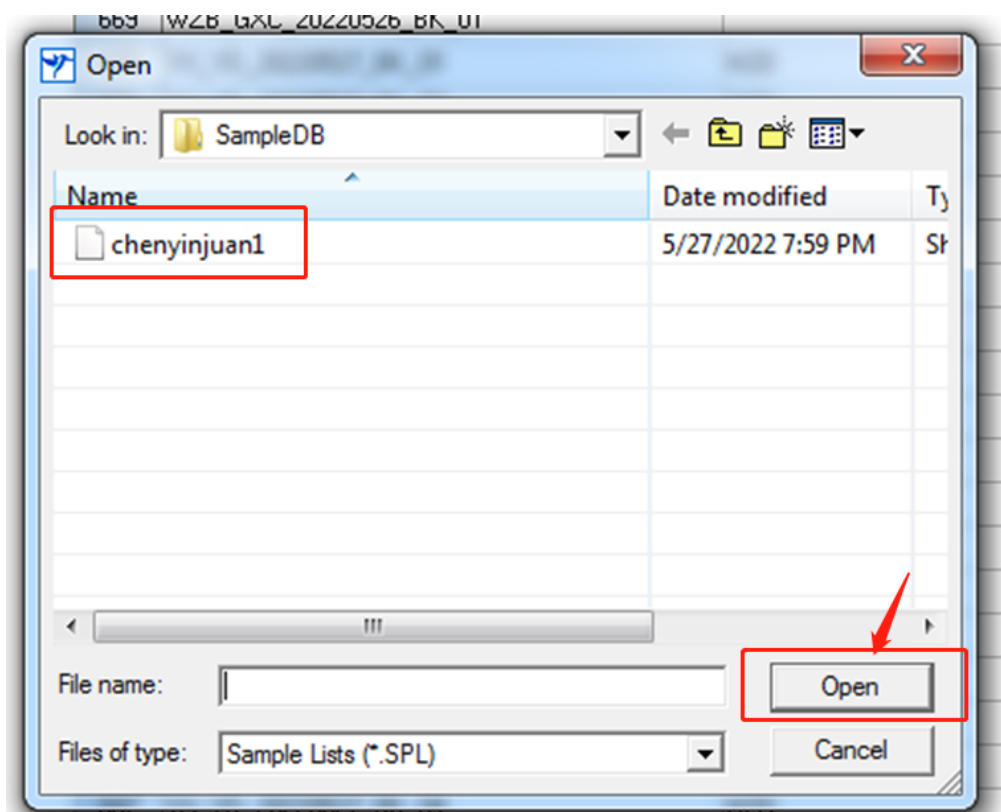


图 6-11

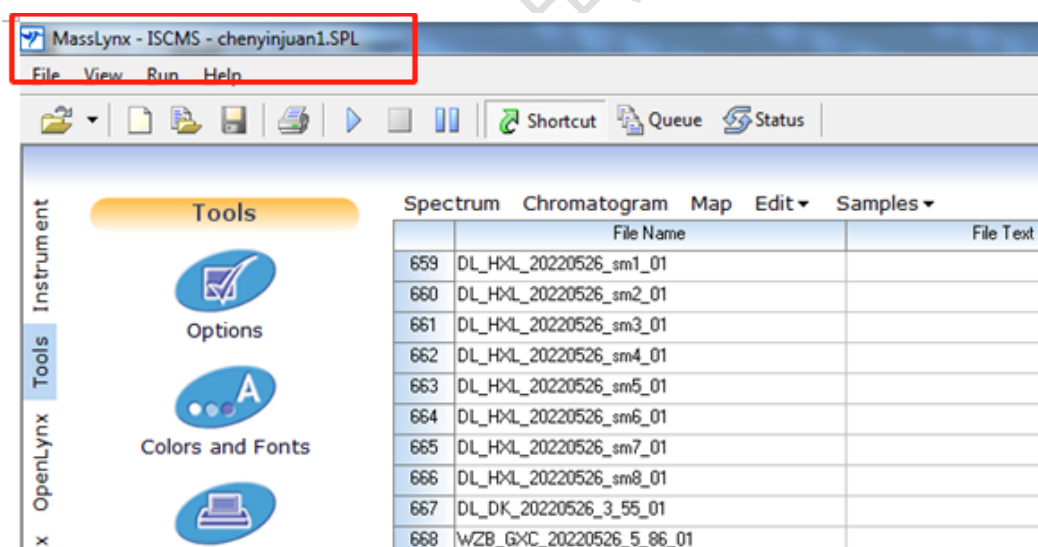


图 6-12

6.5. 仪器准备工作

6.5.1 密封件清洗 (Seal Wash)

Step1. 在 Masslynx 主界面 (Shot cut, Instrument 显示), 点击 MS Console 界面 (图 6-13) 或者点击电脑任务栏 MS Console 图标  (图 6-14), 打开仪器控制台界面 (图 6-15)。

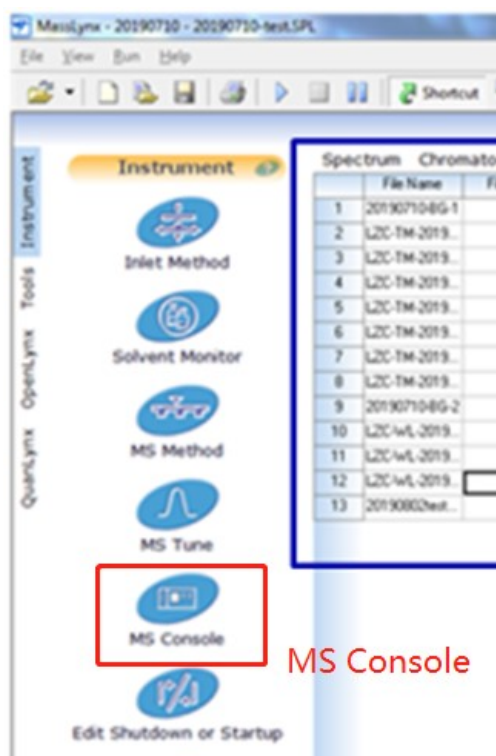


图 6-13



图 6-14

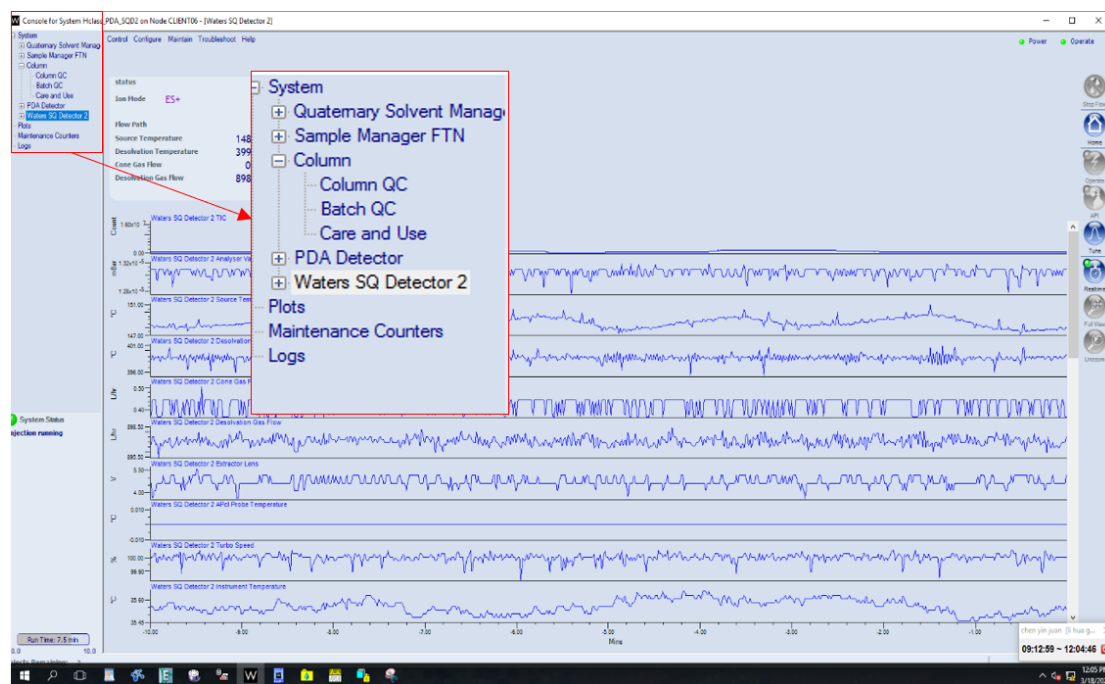


图6-15

Step2. 如图6-16, 选择Quaternary Solvent Manager---点击Control-Prime seal wash, 运行两分钟, 操作者自行记录时间;

注: 再次点击Prime seal wash, 则seal wash 泵运行停止。

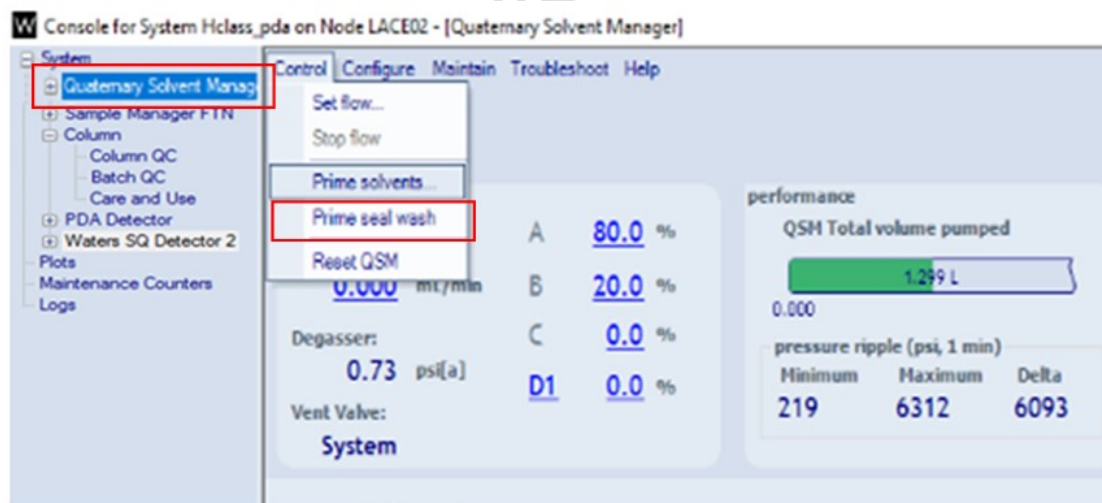


图6-16

6.5.2 Prime solvents 灌注操作

如图6-17, 选择Quaternary Solvent Manager---点击Control-Prime solvents, 选择Control-Prime solvents, 弹出图6-18对话框, 勾选所需的流动相流路(A为水相, B为有机相), 设置每一相流路的灌注时间(2-4 min), 点击Start。灌注操作,

Console界面显示Quaternary Solvent Manager: Priming状态提示（图6-19）。

注：灌注前要确认流动相（A为水相，B为有机相）是否正确，体积是否充足。



图6-17

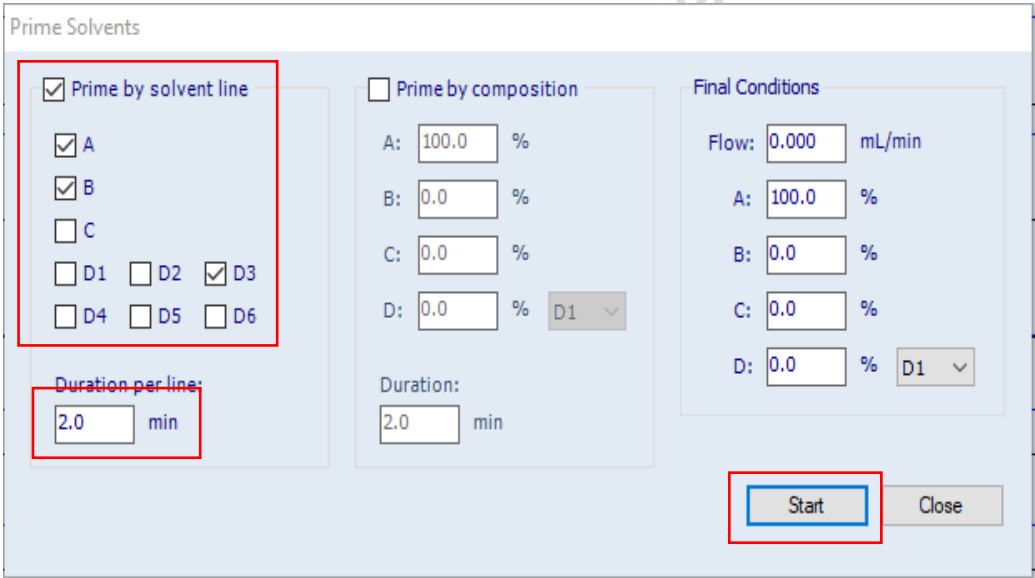


图6-18

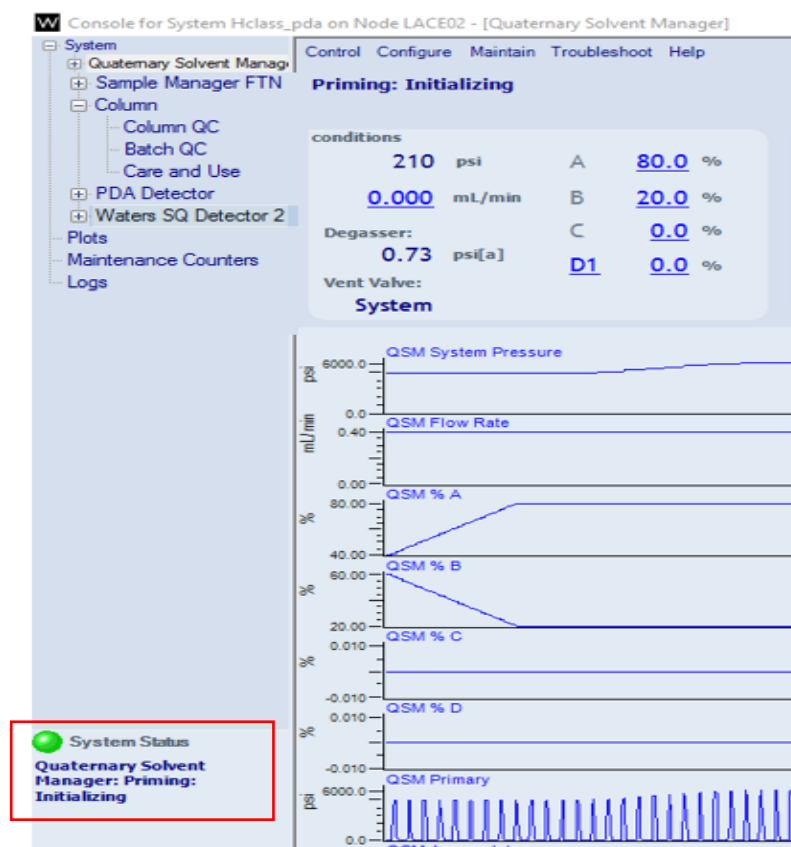


图6-19

6.5.3 自动进样器 Prime 操作

如图6-20, Console界面, 选择Sample Manager FTN; 点击Control-Prime操作, 弹出图6-21对话框。设置Wash Solvent清洗时间为30 sec, Purge Solvent次数为2-5次, 点击OK。样品管理器Purge阶段, Console界面显示Sample Manager: Priming状态提示(图6-22)。仪器灌注清洗结束, Console界面显示如图6-22右图所示, System Status指示灯亮, 无其他状态显示。

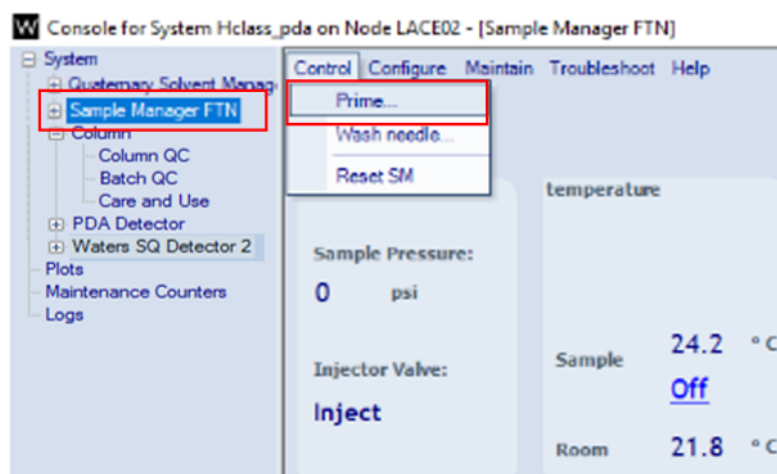


图6-20

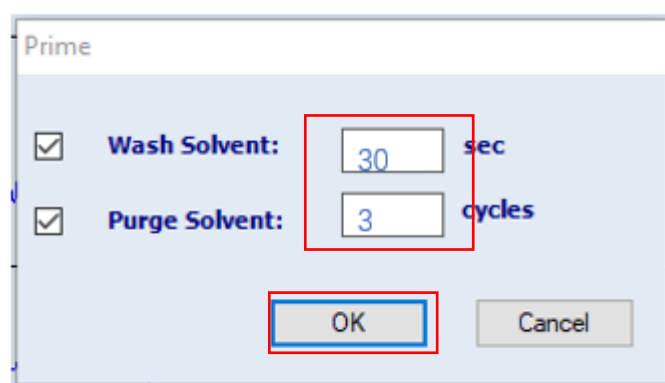


图6-21

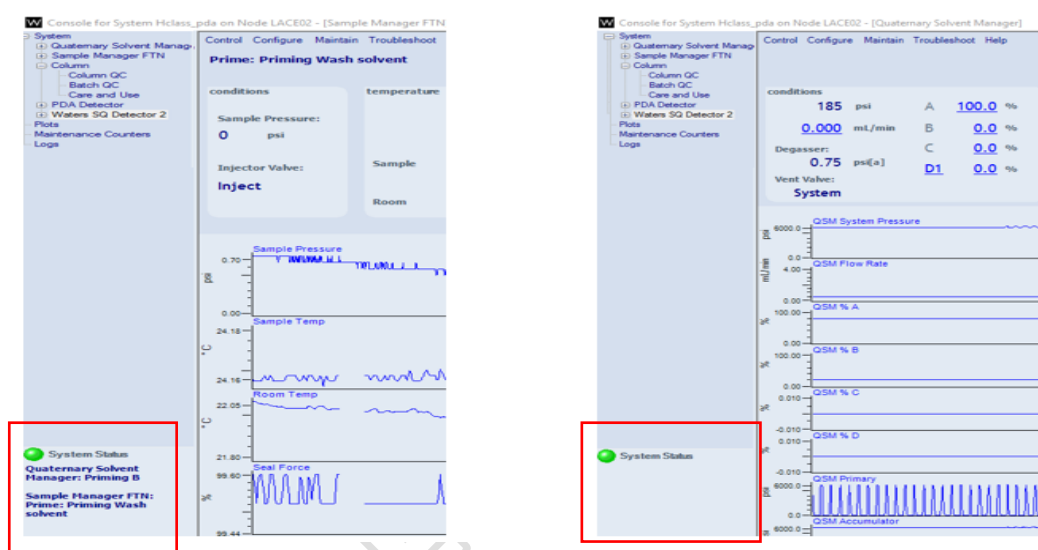


图6-22

注： 先进行Seal wash操作，再进行Prime solvent操作

Seal wash或者Prime solvent可与自动进样器Prime同时操作

6.5.4 开质谱

Step 1. 打开质谱界面。如图6-23，Console界面-选择Waters SQ Detector2-点击右侧Tune图标，打开如图6-24所示的质谱调谐界面。

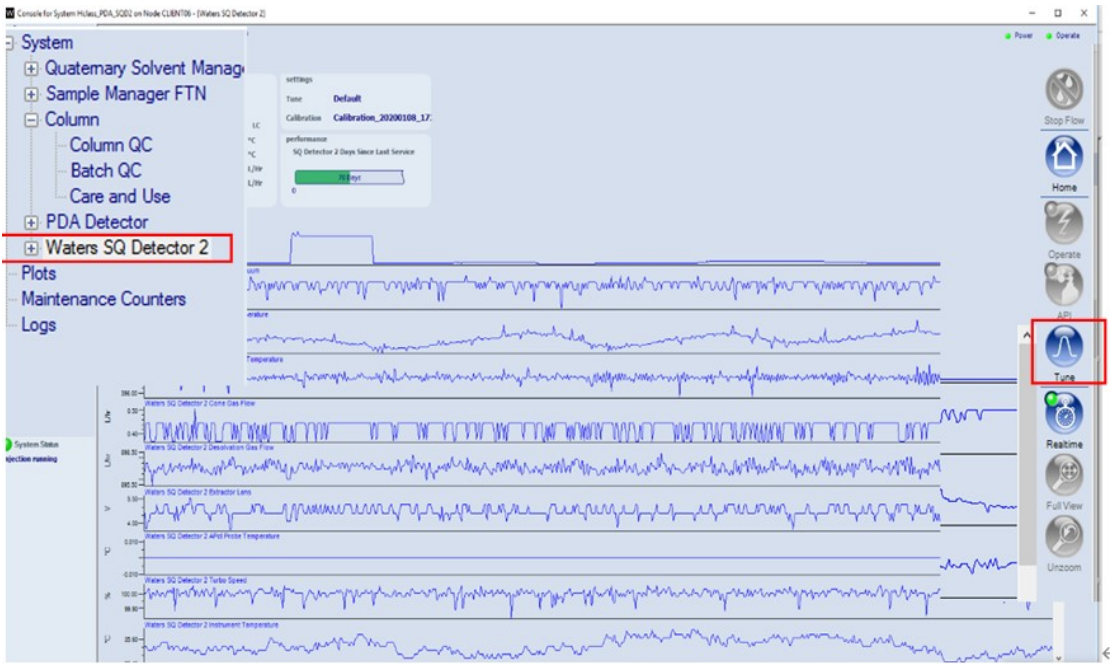


图6-23

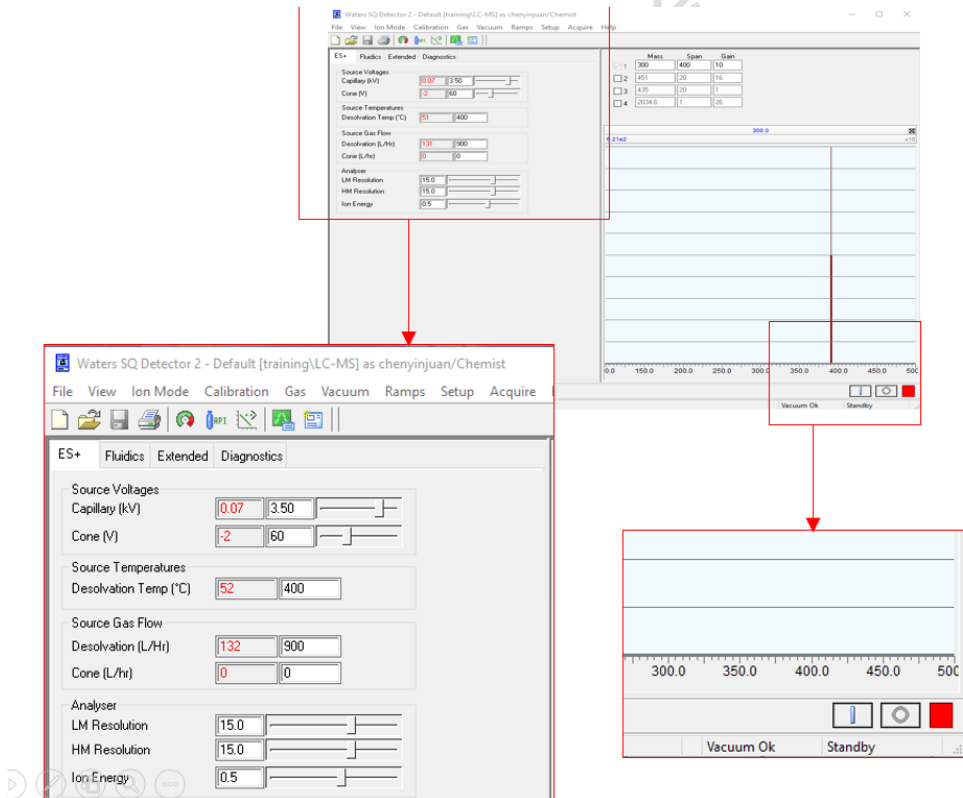


图6-24

Step 2. 开质谱

- (1) Ion Mode: 选择ES+或者ES-模式，一般选择正离子模式；
- (2) 先点击气体钢瓶图标，等待气体实时流量正常；

- (3) 再点击界面右下角 Operate 按钮, 仪器指示灯变为绿色 (图6-25) 且离子源电压加载上

注意: 请先确认 N₂ 气路开关打开且压力正常 (0.6-0.7 MPa)

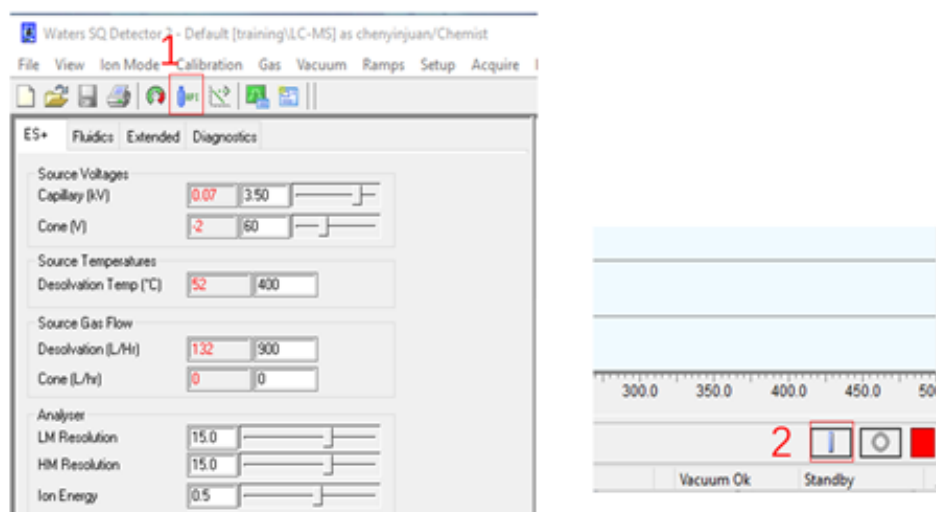


图 6-25

6.6. 运行仪器

6.6.1 编辑样品表

样品列表编辑顺序: 空白 (1-2 针) -标准品 (从低浓度到高浓度) -实际样品-空白 (1-2 针)

Step1. 回到 Masslynx 主界面, 打开个人进样列表或者新建进样列表 (图 6-26)。进样列表每一行序列共包含: 序列编号, File name, File text, MS File, Inlet File, Bottle, Inject volume 和 Control 共 8 列。选择序列-右键-Add, 可在当前基础上增加数个序列

- ① File name: 必填项, 文件名称, 即某一样品测试所有结果的总文件名。
- ② File text: 选填项, 可输入样品名称或编号等信息;
- ③ MS File: 必填项, 质谱方法文件;
- ④ Inlet File: 必填项, 色谱方法文件;
- ⑤ Bottle: 必填项, 样品瓶位置;
- ⑥ Inject Volume: 必填项, 注入体积;
- ⑦ Control: 选填项。

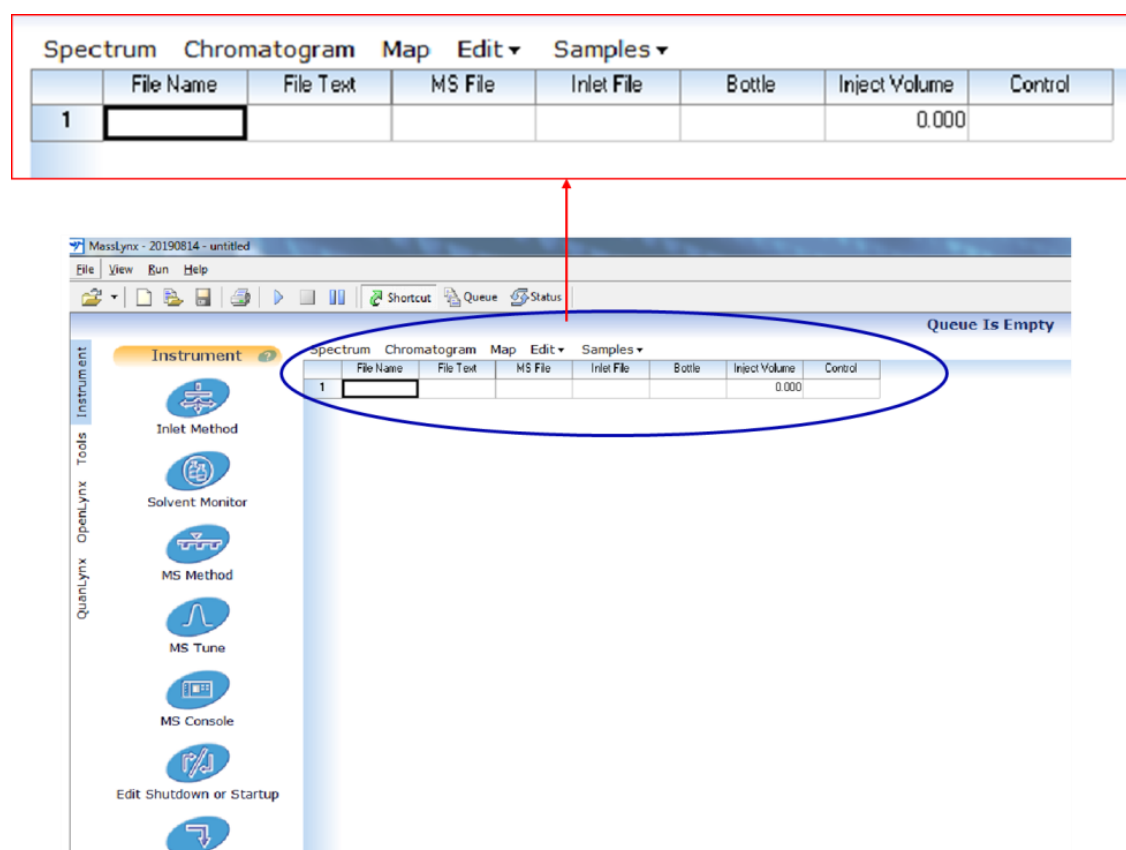


图 6-26

➤ 文件名(File name)

如图 6-26, 在 Masslynx 操作界面主页, 选中 File name 下方空格, 双击至显示光标, 即可输入文件名。

- 命名原则: 导师姓名首字母(大写)_个人首字母(大写)_日期_样品编号_测试序号, **中间用下划线连接, 不要用连字符**

例如: 张三老师李四的样品, 测试时间为 2017 年 6 月 15 日, 样品编号为 sm1, 进行第一针测试, 那么文件命名为: **ZS_LS_20170615_sm1_01**

- 进行二次测试, 则增加另一序列, 文件名为 ZS_LS_20170615_sm1_02, 以此类推。

注: (1) File name 不可重复;

(2) 进样行不够, 请右键-add, 可增加若干实验序列, 默认添加的序列, **禁止删除已运行的测试行**。新建行中 File name, Bottle 等以数字结尾的, 系统自动按数字或样品瓶序列进行自动增加。

➤ 编辑 File Text 列

此为用户个性化编辑窗口, 输入字段主要用于提醒, 比如样品的差异性, 方法差

注意：反相洗脱，高比例水相到高比例有机相，平衡一段时间，回到初始比例，柱后平衡至少2分钟。非特殊色谱柱，禁止用100%水相。

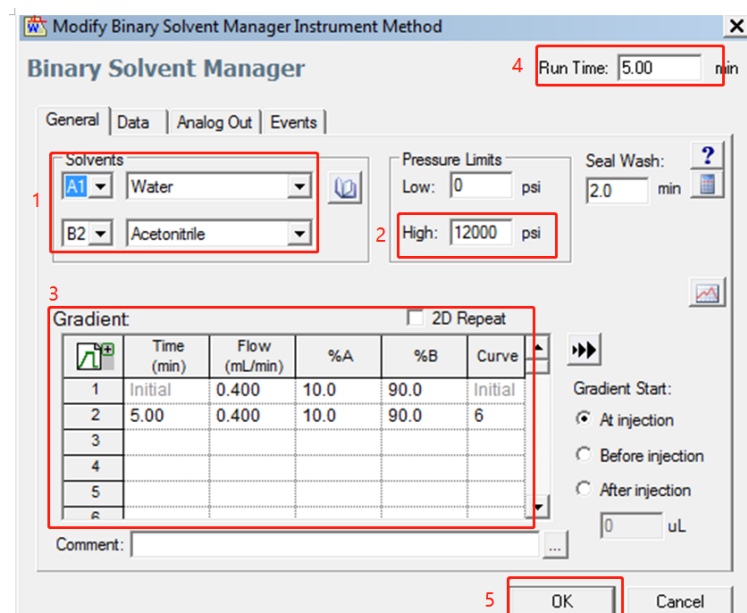


图 6-29

Step 3. 编辑自动进样器 Autosampler

在图 6-28 中，点击左侧 Autosampler 图标，弹出图 6-30。可根据色谱分析温度和样品要求设置柱温箱温度及样品箱温度，点击 OK 确认。

- 注：（1）样品对温度不敏感，可不设样品箱温度；
- （2）柱温箱不可降温，温度设置需综合考虑色谱柱温度耐受性；
- （3）在 Run time 窗口，输入总的运行时间。

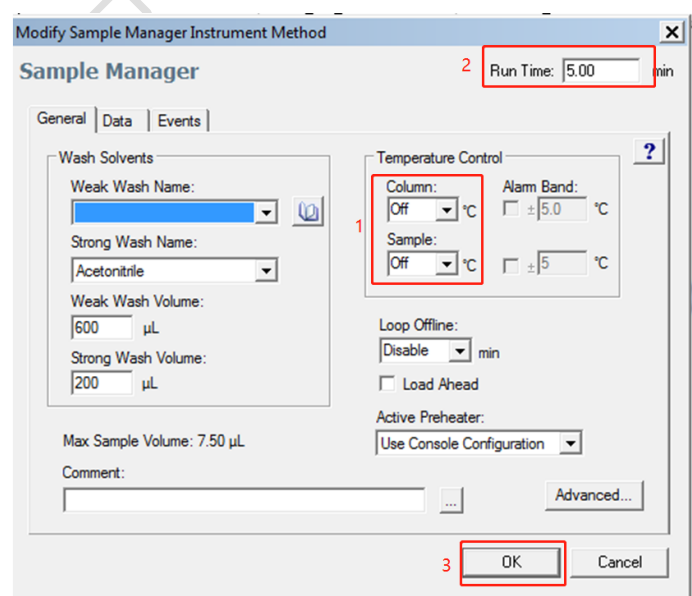


图 6-30

Step 4. 保存方法

请检查所有的方法设定项, 确认无误, 点击 File-Save, 保存方法。为便于快速识别个人液相方法, 建议方法命名原则为: 用户名首字母大写_体系_色谱柱_时间, 比如: LRZ_TCM_T3_16min。

使用该液相方法, 可选中 Inlet File 小格-右键-Browse, 即可调用。

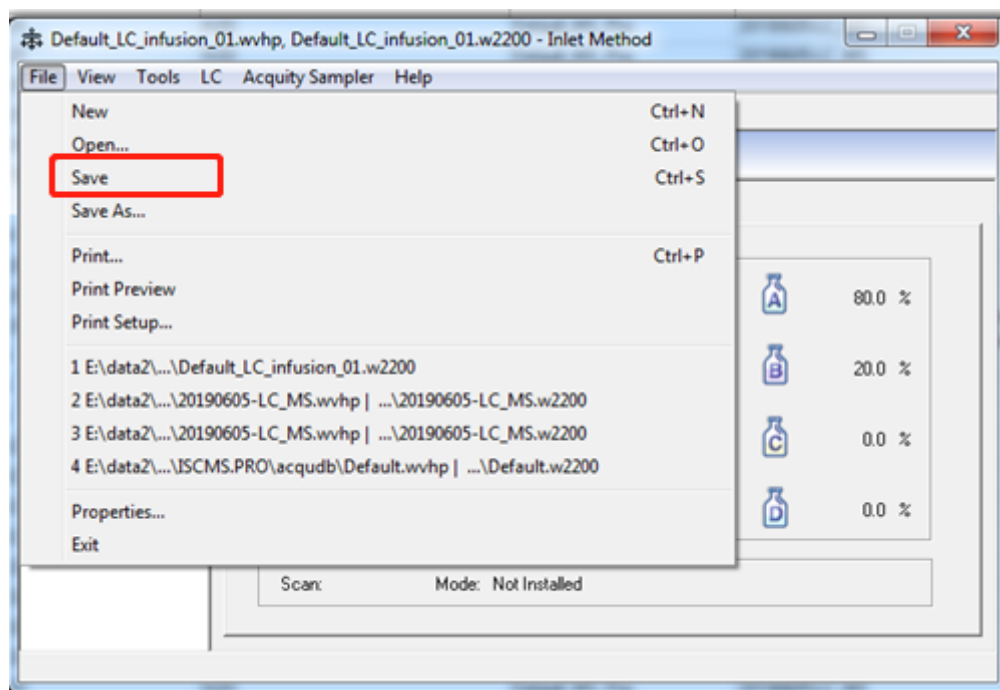


图 6-31

➤ 建立质谱方法文件(MS File)

选中 MS File 下方空格-右键- Edit, 弹出 Experiment setup 对话框, 即可编辑质谱采集方法。质谱共有两种采集模式: 选择离子模式 (SIR) 和 MS 全扫模式 (MS Scan)。如果是进行 SIR 模式采集, 即填入相应化合物的离子质荷比。

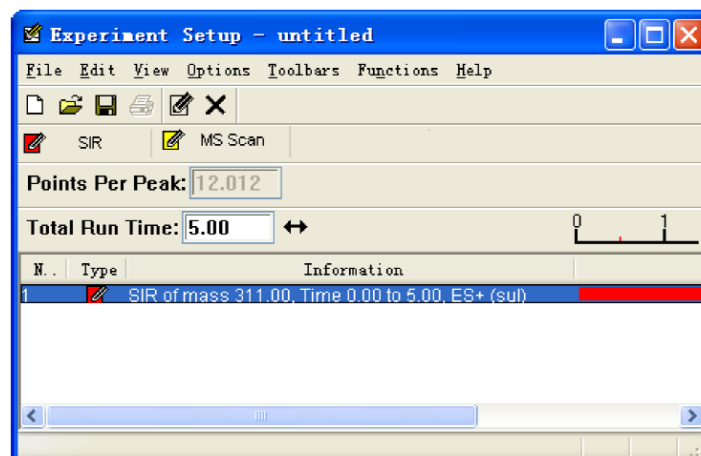


图 6-32

点击 SIR 模式, 编辑: 离子化参数, Span 设置为 0.5 Da, 质谱运行时间 (Star 和 End, 一般与液相色谱运行时间一致)。右侧表格输入要观测化合物的名称及质荷比信息, 点击 OK。

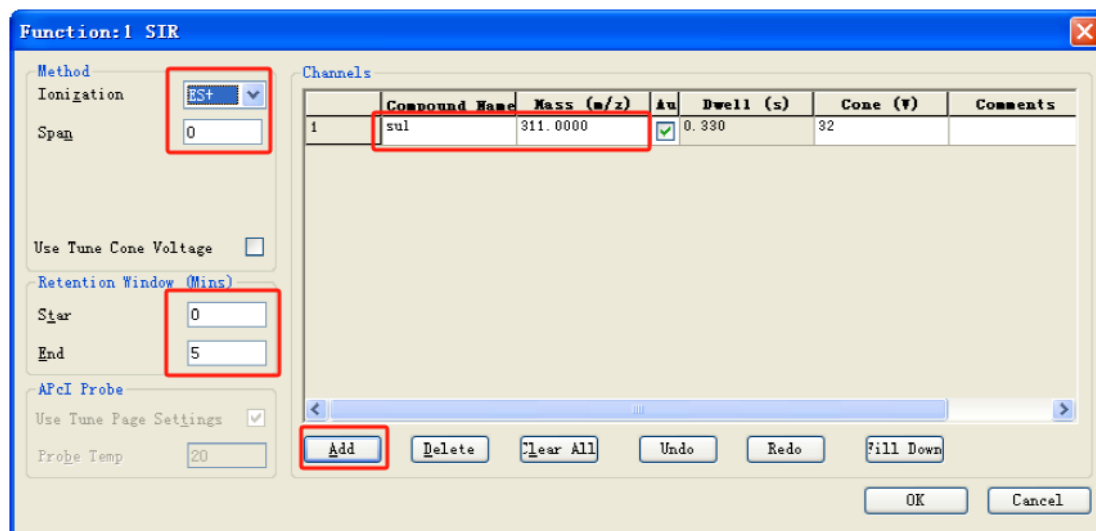



图 6-33

质谱方法建立好, 选择 File-Save as 保存质谱方法。

样品中如果有盐, 请尽可能进行脱盐处理; 如有少量的盐无法除去, 应加入阀切换事件, 具体操作务必联系管理员。

6.6.3 选择色谱、质谱方法

回到 Masslynx 主页, 在 Masslynx 操作界面主页, 选中 Inlet File (或 MS file) 下方空格...右键... Browse, 选择 6.6.2 步骤中建立的色谱及质谱方法文件。

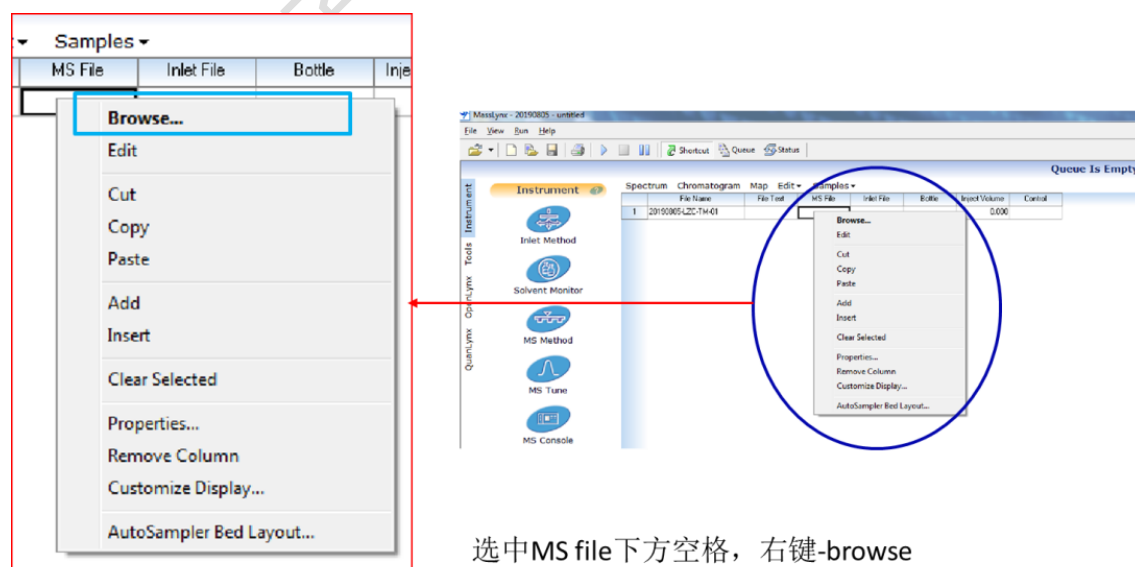

选中MS file下方空格, 右键-browse

图 6-34

6.6.4 样品位置选择(Bottle)

图 6-35 是自动进样样品盘实物图。样品盘规格为 6*8, 以缺角至于左上角为正向, 放置在样品管理器中, 每个样品管理器共有两个。

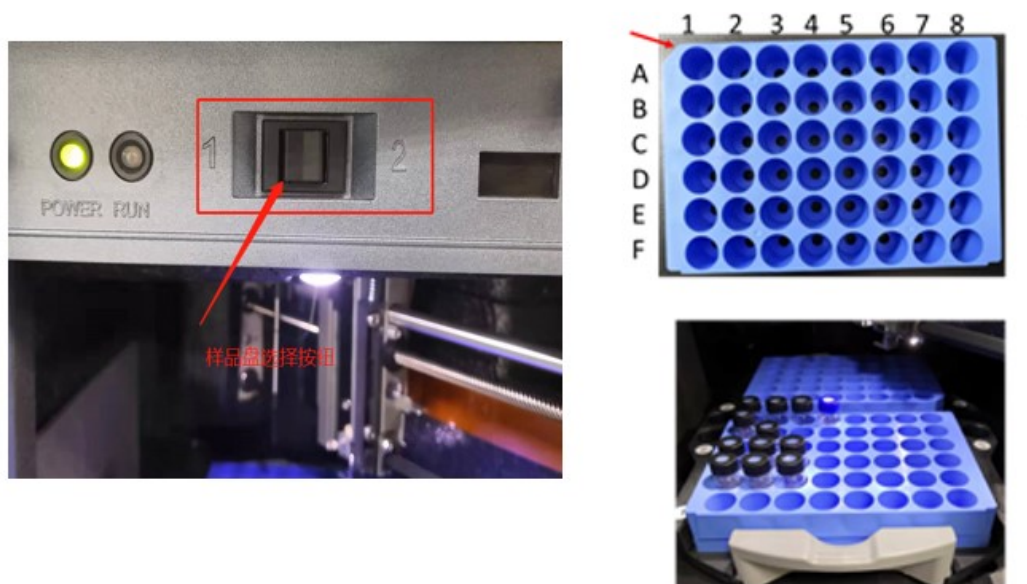


图 6-35

样品管理器共有两个样品盘, 样品盘通过自动进样器1/2按钮进行选择 (图 6-35)。

注: (1) 放样时间可灵活处理; (2) 两个样品盘必须通过1/2按钮选择样品盘; (3) 放样: 先开门, 再将样品盘托盘移至门口, 取出样品盘, 将样品盘托盘推至自动进样器腔体; 放完样品重复上述操作, 将样品盘放置托盘中。 (4) 样品盘需水平贴合样品托。

样品瓶位置有两种输入方法, 操作如下:

手动输入: 选中 Bottle 下方空格, 双击至出现光标, 输入格式如下

样品盘:行标,列标

例如:1 号样品盘, A 列, 2 号位, 则输入: 1:A,2

自动输入: 选中 Bottle 下方空格, 右键-Auto Sampler Bed Layout, 出现样品盘选择器(图 6-34 (b))。根据自己放置的样品盘位置, 首先选中样品盘, 然后点击行标列标的具体位置, 最后点击 replace, 关闭窗口, 即可。

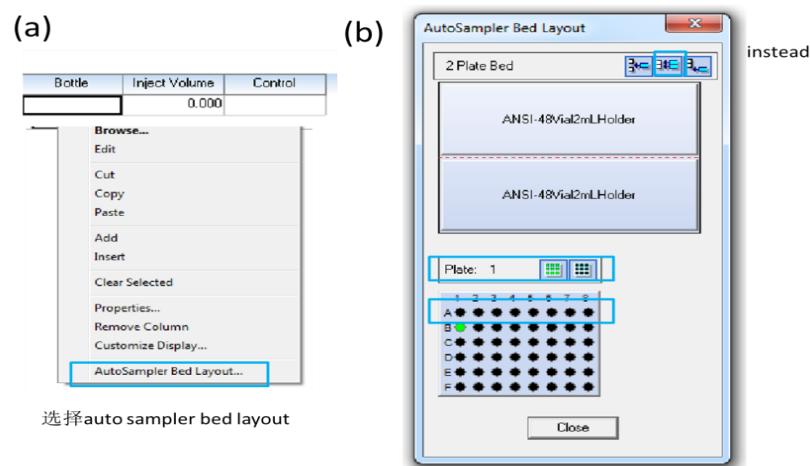


图 6-36

6.6.5 进样体积(Inject Volume)

选中 Inject volume 下方空格，双击至出现光标，输入 2，回车。

注：常规进样体积为 2 ul，如果样品浓度过高，务必稀释；或者减小进样体积。非定量测试，可进 0.5 ul，0.1 ul 等。

6.6.6 保存样品表并运行方法

- 保存样品表：如图 6-37，核对方序列中的方法和其他信息无误后，保存序列。File - Save。新建的进样列表，请以用户名全拼小写保存。

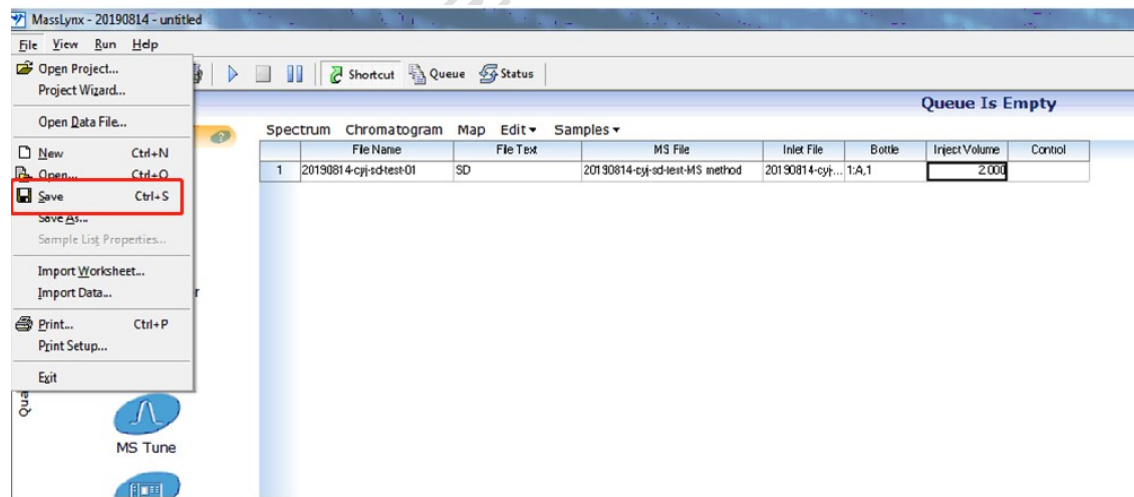


图 6-37

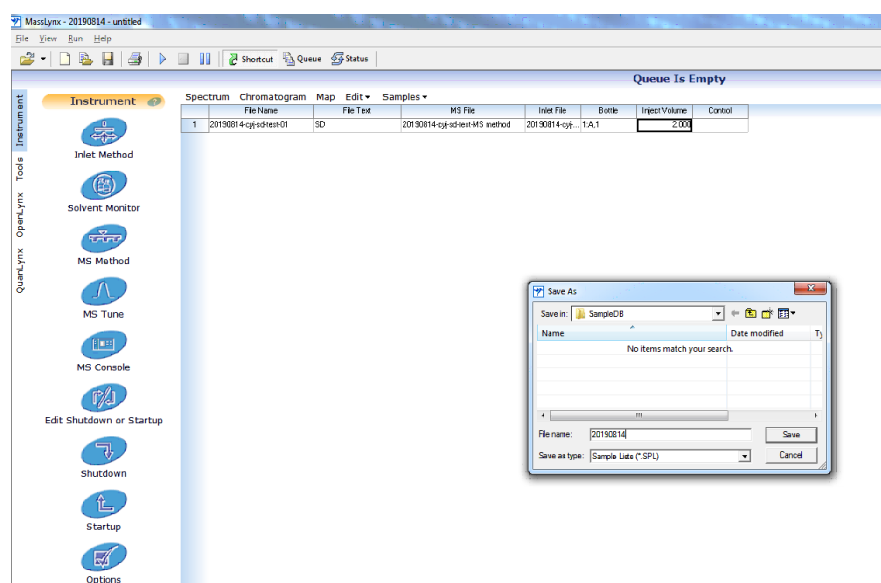


图 6-38

➤ 加载方法:

打开液相方法窗口, 点击图 6-39 的 Load Method, 加载液相方法, 这时液相色谱仪器开始按用户编辑的方法进行升温、加载初始流动相。

当 Console 界面, 系统压力差小于 30 psi (图 6-40), 可以运行样品。

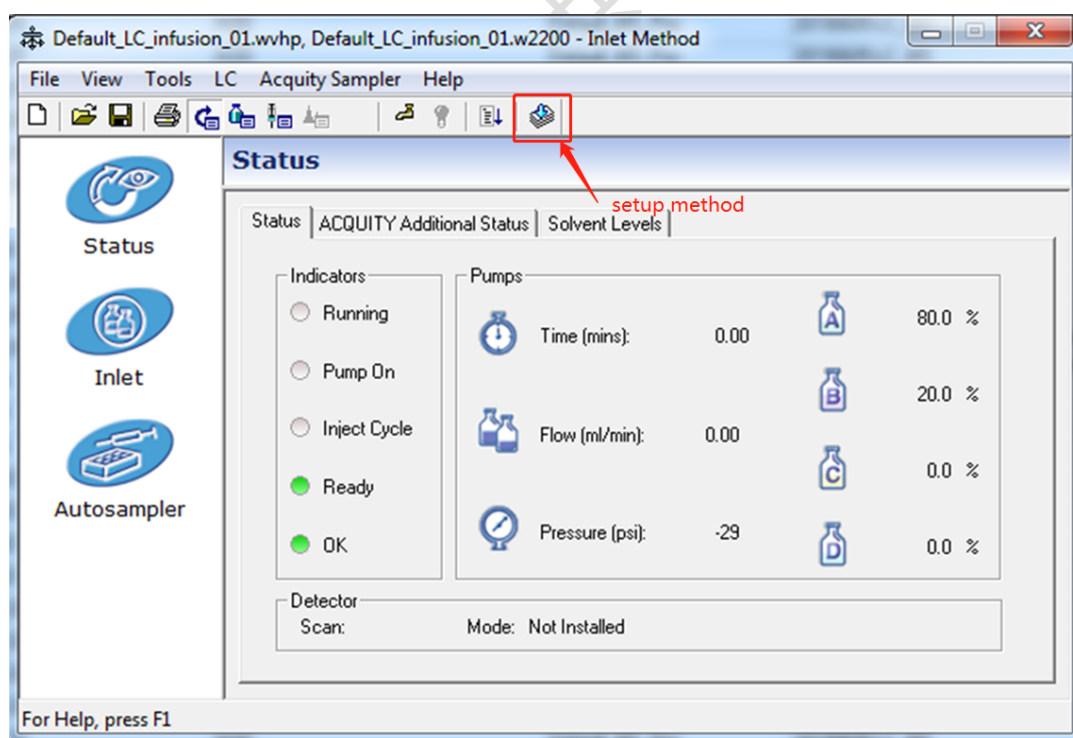


图 6-39

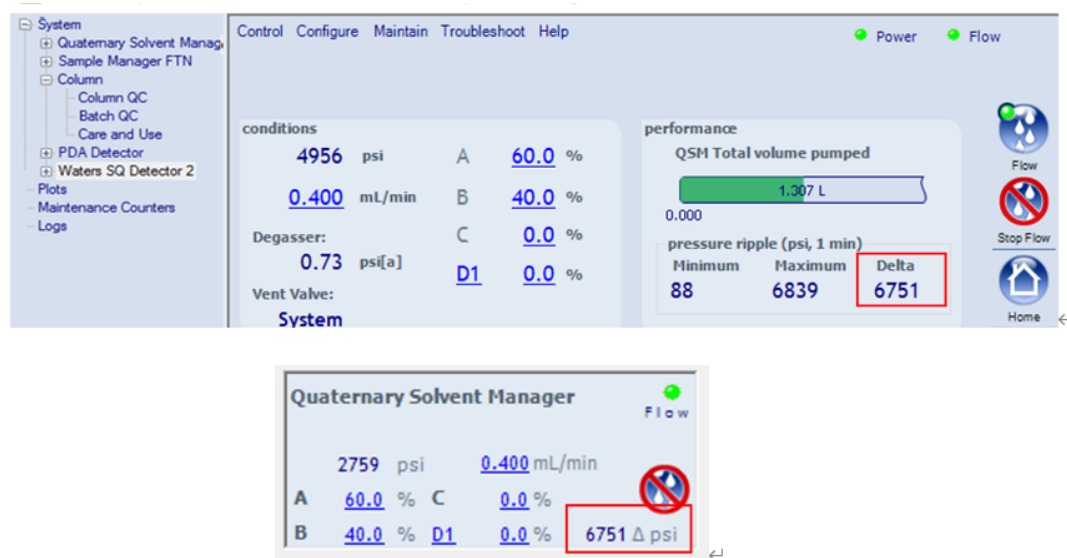


图 6-40

➤ 提交运行

选中编辑好的序列，点击三角形图标(Start run) (图 6-41)，弹出图 6-41 对话框。

注：运行样品之前，一定要先加载液相方法，Load 液相方法后，溶剂管理器开始运行，待 Console 界面，溶剂管理器系统压力差 < 30 psi，流动相初始比例达到平衡。

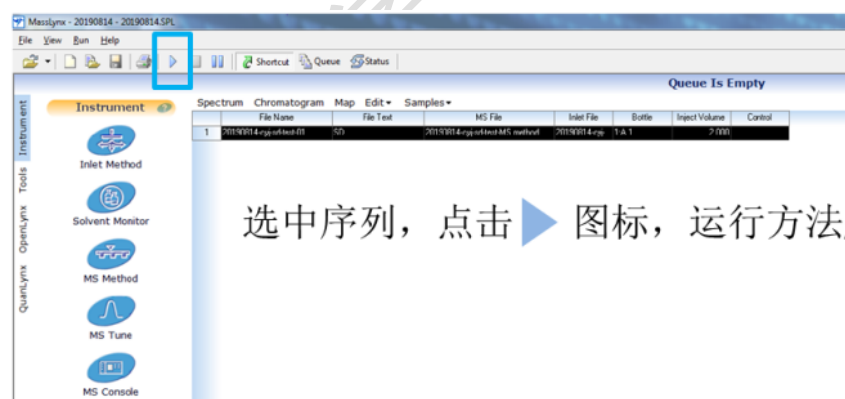


图 6-41

➤ 确认运行的样品编号

点击 Start run，弹出 Start sample list run，显示要运行的序列编号范围，确认无误，点击 OK。此时序列开始运行，当前运行的序列，有绿色进度显示。运行结束，绿色进度状态消失。

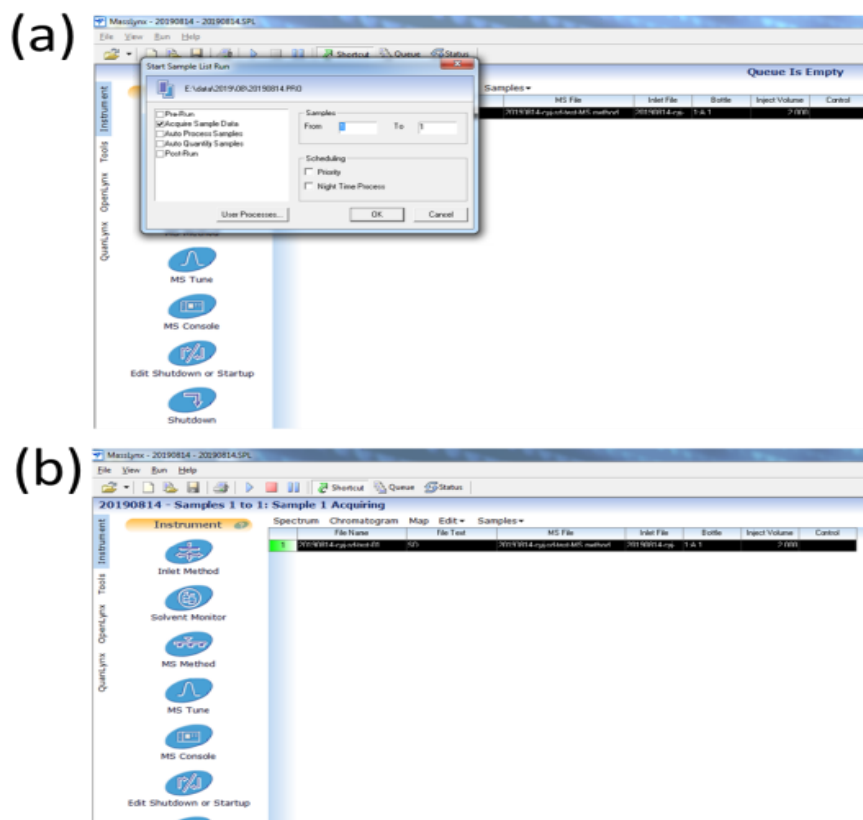


图 6-42

注意：

- (1) 提交运行之前，务必保证样品位置和方法正确；
- (2) 正在运行的样品，行序号显示为绿色；运行期间，已经提交运行的样品行不可以修改。修改其他行，会导致正在运行的绿色显示消失，重新保存即可。
- (3) 运行期间，可以增加新的样品、编辑新的样品行，但上样禁止在仪器进样前后 2 min（即进样前 2 min+结束后 2 min）开自动进样模块上样，否则可能会导致仪器故障；
- (4) 禁止删除已经运行的样品行。

6.7. 数据查看**6.7.1 查看色谱图**

选中运行结束的序列，点击 Chromatogram（图 6-43）。

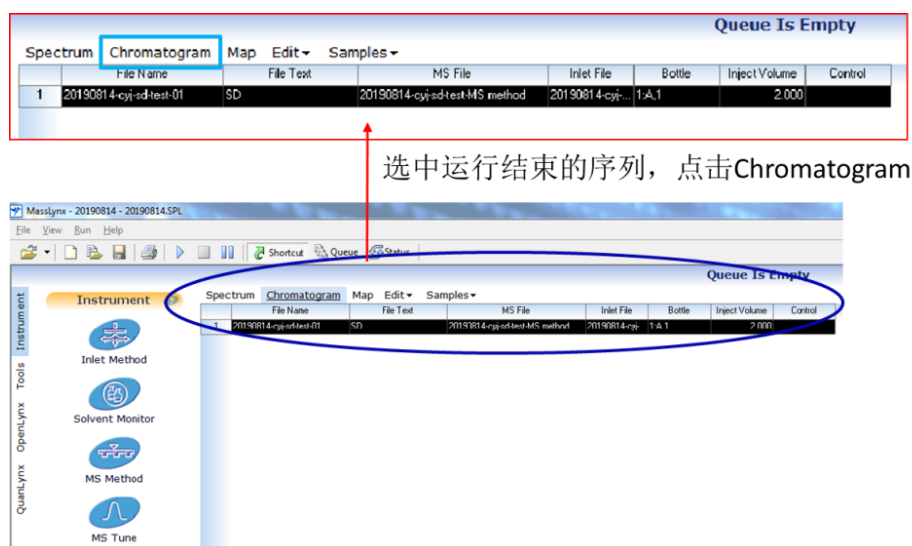


图 6-43

6.7.2 查看质谱图

- 查看某保留时间处的质谱图：在色谱图上某点处双击。
- 查看某段保留时间的质谱图：在色谱图上，按住右键拖拽目标时间段即可（水平拖动，勿使用方框选择）。

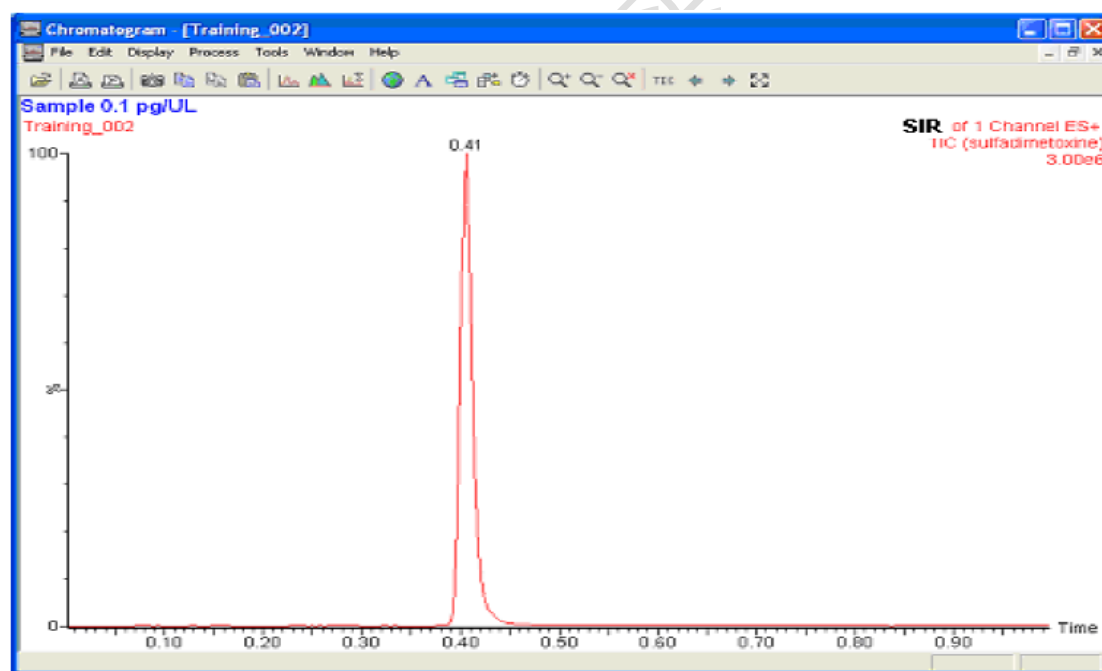


图 6-44

- 捕获质谱图。在质谱图窗口，点击照相机，复制质谱图，打开电脑中的 Paint 画图，粘贴并另存；

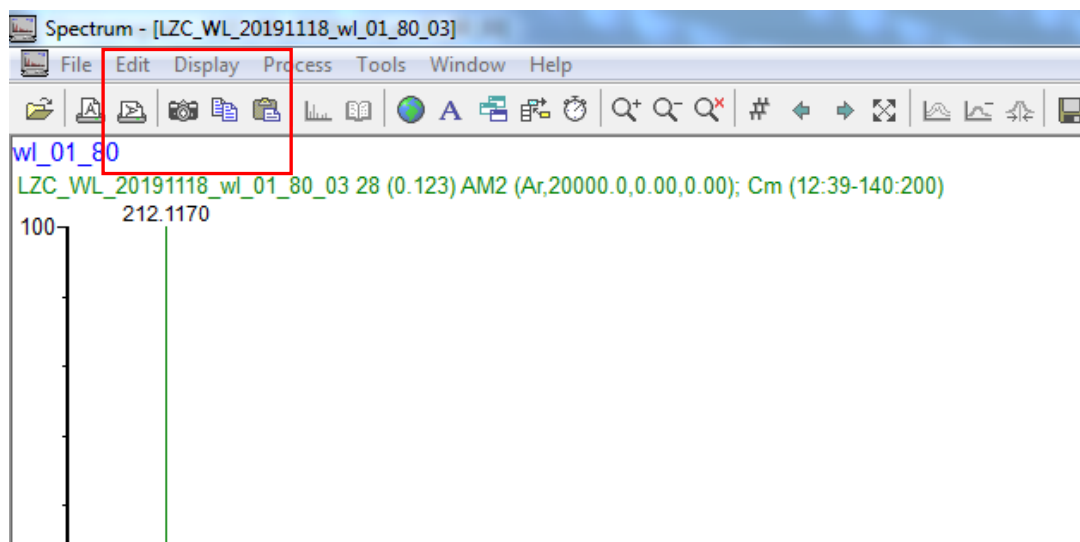


图 6-45

- 获取原始数据。选择 Edit - Copy spectrum lists 复制质谱原始二维数据，新建 Text document 文本文件进行粘贴即可。该 txt 文本可以进一步用 Origin 进行处理。

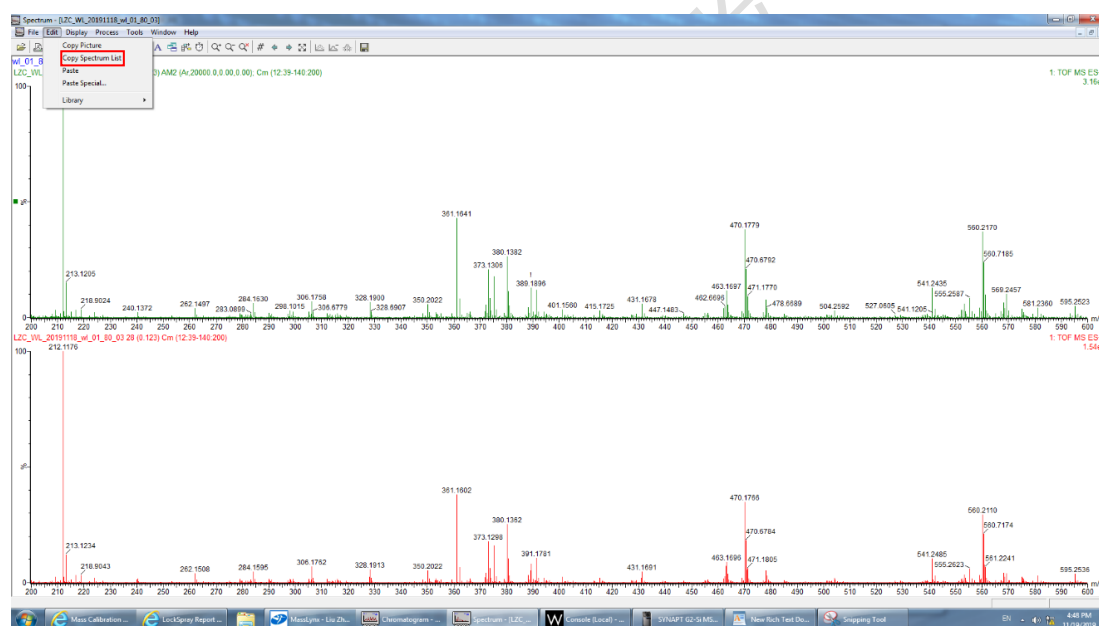


图 6-46

6.7.3 查看多个通道结果

如果方法中包括多个通道，可通过 Display...Mass 查看。选择 Add trace，单击 OK。

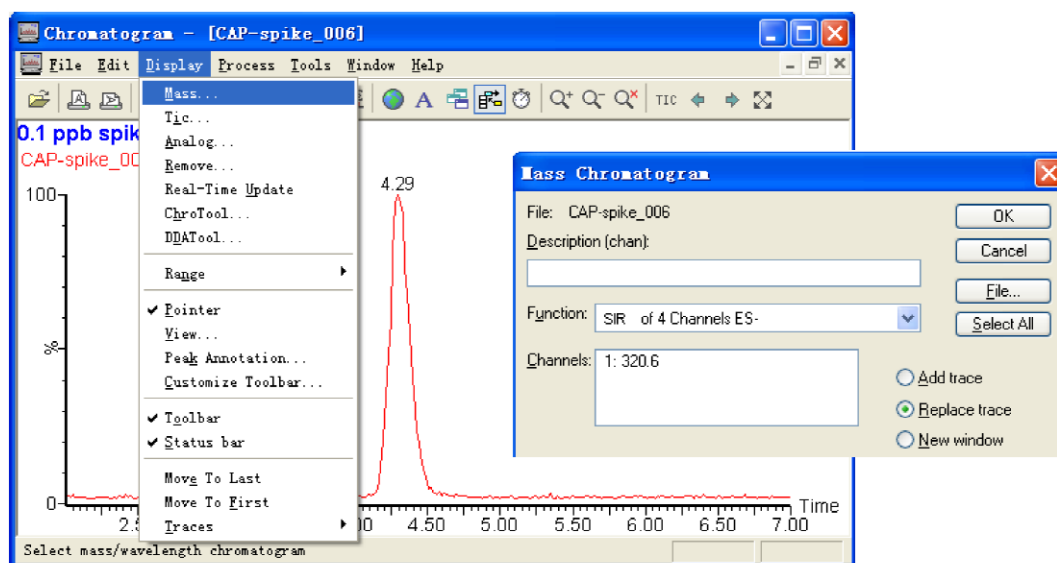


图 6-47

6.7.4 数据保存

请先注册Storage账号。将处理的数据结果保存在学校数据中心指定的Storage数据传输路径下，并在个人本地电脑下载软件进行数据下载。如需原始数据，也请Copy到自己的Storage文件下。**严禁删除操作电脑上的原始数据，也禁止采用U盘或硬盘进行下载传输。**

6.8. 实验结束处理

6.8.1 样品运行结束，走两针溶剂空白，最后用100%乙腈冲洗10倍柱体积；

6.8.2 关色谱：

- 停流速：Console界面，Quaternary Solvent Manager子窗口，点击流速，在Set Flow弹出界面，设置流速为0，点击对勾确认即可；
- 停温度：Console界面，Sample Manager，降温设为0，回车，最终显示off；
- 关闭紫外灯：Console 界面，PDA Detector...Control... Set lamp...,设置为off;

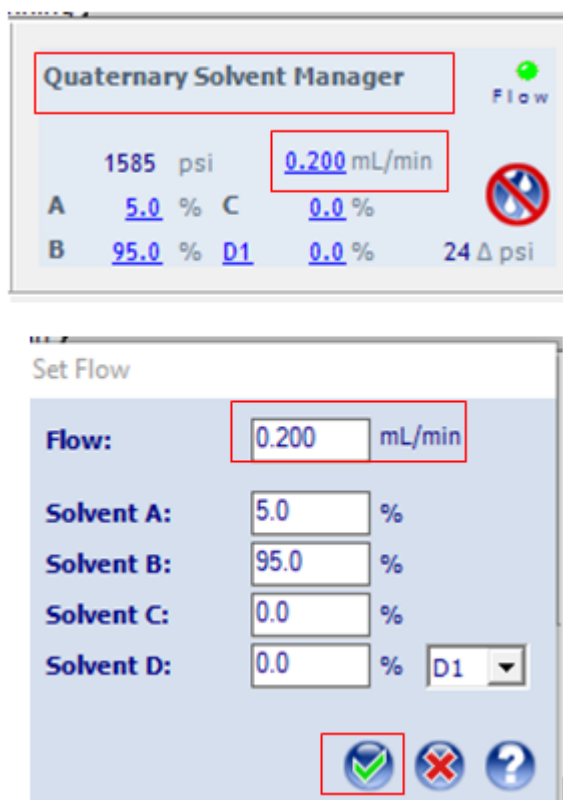


图 6-47

6.8.3 关质谱

在 Waters SQ Detector 2 调谐界面, (1) 点击右下角 Standby 图标, 绿灯变红色, 离子源电压卸载; (2) 等待左测 **Source Temperatures Desolvation** 温度降低至 **100 °C 以内**; (3) 点击气瓶快捷图标, 关闭氮气 (图6-48)。

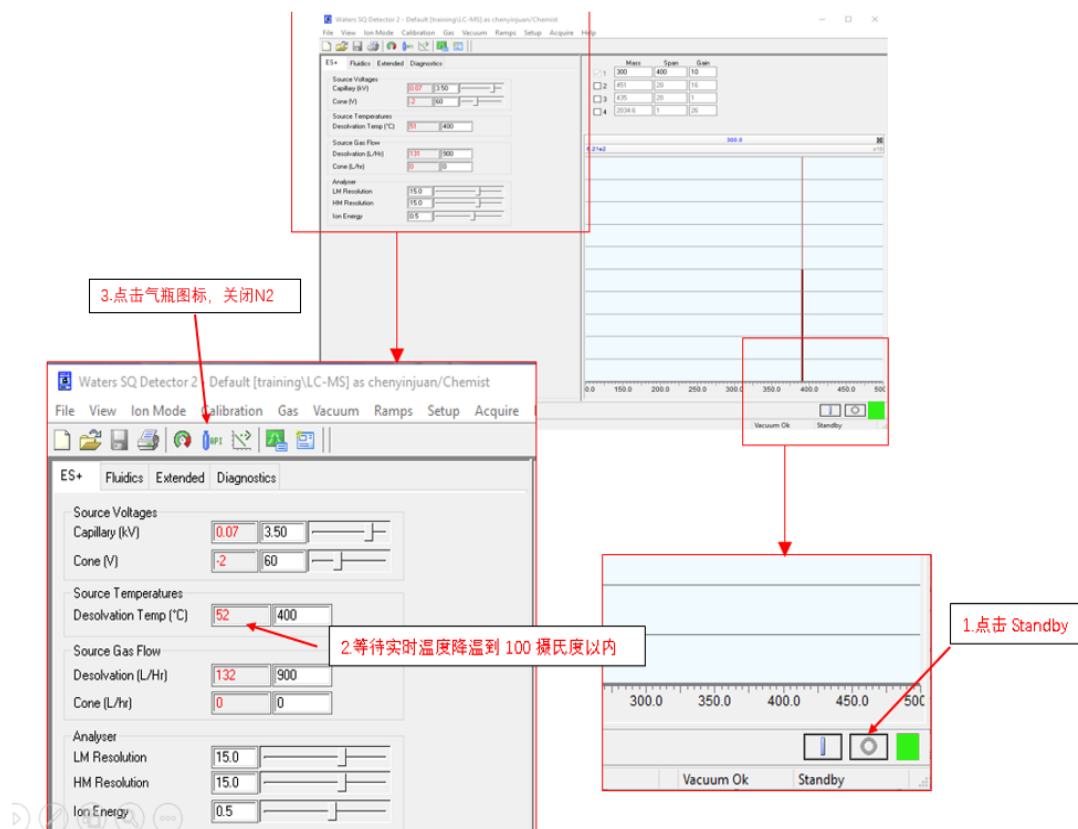


图6-48

6.9. 退出操作

色谱和质谱关闭后, 将软件最小化, 不要关闭软件。离开实验室前, 请进行测试登记, 从样品管理器中取出测试样, 整理实验桌, 确认无误后, 方可离开。请注意: 使用前先检查仪器状况流动相体积, 尤其确保水相为新鲜, 一切正常方可操作; 一旦开始实验, 默认为使用前仪器状况良好; 使用过程中出现故障须立即联系技术员; 测试后请及时取回样品。

7. 相关/支撑性文件

Q/WU FLHR001 文件编写规范

8. 记录

单四极杆液质联用仪使用登记表。

单四极杆液质联用仪使用登记表								
日期 (yy,mm,dd)	使用人	导师	检测方式 (√)		样品数	数据路径(课题组-用户-日期)	仪器状态	备注 (仪器报错; 培训/上机; 流动相说明等)
			送样	自主			正常√	
2019.12.18	张三	王五		√	2	Wangwu_Zhangsan_1218	√	上机考核

**请注意: 使用前先检查谱仪状况, 一切正常方可操作; 一旦开始实验, 默认为使用前谱仪状况良好; 使用过程中出现故障须立即联系技术员; 测试后请及时取回样品。